




Das einzige Messgerät mit
**Blood Sugar
Mentor™**

Jetzt NEU: OneTouch Ultra Plus Reflect™

Lassen Sie uns Ihren Patienten helfen,
tiefere Einblicke in ihre Blutzuckerwerte
zu erhalten

Mit Anbindung an OneTouch Reveal® eine der am häufigsten
heruntergeladenen Diabetes-Apps der Welt*



OneTouch Ultra Plus Reflect™ ist auch in mmol/L erhältlich

ONETOUCH®
Jeder Schritt ein Schritt nach vorn™

* Research2Guidance Marktdaten Diabetes-App Q1–Q4 2017.

iOS ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke der Apple Inc. App Store™ ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc. Android™ und Google Play sind Marken der Google Inc.

© LifeScan Deutschland GmbH, Düsseldorf, Deutschland – EMCO/UPR/1118/0183. Stand: November 2018

Interpretieren und handeln auf Basis von Blutzuckerwerten

Mangelndes
Verständnis




> 70 % erkannten erhöhte Blutzuckerwerte nicht.¹

Untätigkeit



54 % der insulinpflichtigen Patienten reagierten nicht regelmäßig auf Über- oder Unterzuckerung.²

Schlechte
Einstellung

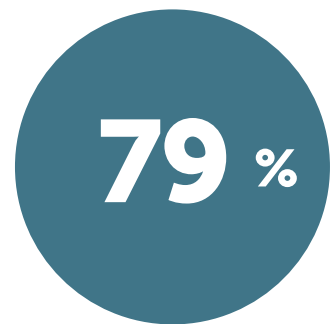

Bei 79 % war der Blutzuckerspiegel schlecht eingestellt.³

Wie können wir Ihre Patienten dabei unterstützen, Fortschritte in ihrem Diabetesmanagement zu machen?

1 Evans JMM, et al. Self-monitoring of blood glucose in type 2 diabetes: patients' perceptions of 'high' readings [Blutzuckerselbstmessung bei Typ-2-Diabetes: Ansichten der Patienten zu 'hohen' Werten]. Diabetes Res Clin Practice 2013;102(1):e5-e7. Von 207 Studienteilnehmern, die keine Insulintherapie anwandten, vermochten 28 % einen Blutzucker-Messwert von 393>235 mg/dl als überhöhten Wert zu erkennen.

2 Polonsky WH, et al. A survey of blood glucose monitoring in patients with type 2 diabetes: are recommendations from health care professionals being followed? [Befragung zur Blutzuckerselbstkontrolle bei Typ-2-Diabetes: Werden Empfehlungen des medizinischen Fachpersonals eingehalten?] Curr Med Res Opin 2011;27 (suppl 3):31-37. Auswertung von Patientenangaben zur Blutzuckerselbstmessung. 54 % der 320 Befragten gaben an, bei Über- und Unterzuckerung keine Maßnahmen zu ergreifen.

3 Gopinath B. et al. Study of factors associated with poor glycemic control in Type-2 Diabetes patients. [Untersuchung der mit mangelhafter glykämischer Kontrolle assoziierten Faktoren bei Patienten mit Typ-2-Diabetes] Global Journal of Medicine and Public Health 2013;2(2):ISSN# - 2277-9604. In einer in Indien durchgeführten Studie mit 500 Teilnehmern war bei 393 die glykämische Kontrolle unzureichend (HbA1c ≥ 7 %).

Jetzt NEU: OneTouch Ultra Plus Reflect™


Blutzuckerwerte können Probleme aufzeigen, aber keine Lösungen. Wie fänden Sie es, wenn Ihre Patienten nicht nur die bloßen Zahlen sehen, sondern sie auch besser verstehen und direkt reagieren könnten?

Das neue OneTouch Ultra Plus Reflect™ ist das einzige Messgerät mit einem **Blutzucker-Mentor**, der personalisierte **Empfehlungen** bietet, **Verständnis** schafft und die **Motivation** stärkt, um Patienten zu helfen, entsprechend zu reagieren, sodass sie **Über- und Unterzuckerungen vermeiden** können.*



Blutzucker-Mentor Meldungen sofort, direkt am Bildschirm des Messgerätes

Empfehlungen

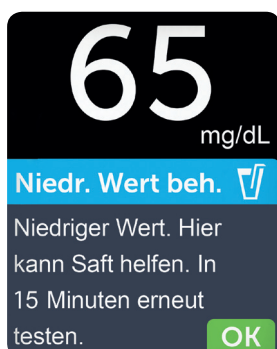


Bietet Empfehlungen in Echtzeit, um dem Patienten zu helfen, Über- und Unterzuckerung zu vermeiden.

Verständnis



Hilft dem Patienten, die Auswirkungen von Essen, Bewegung und Medikamenten auf den Blutzucker zu verstehen.

Motivation

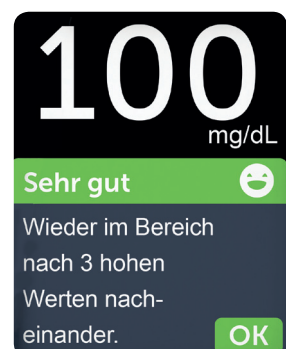

Hilft dem Patienten, motiviert und am Ball zu bleiben, um seine diabetesbezogenen Ziele zu erreichen.


* Therapieentscheidungen müssen sich nach dem absoluten gemessenen Wert und den ärztlichen Empfehlungen richten.

Noch **mehr Informationen**, wenn der Patient sein Gerät mit der **OneTouch Reveal® Mobile App** verbindet

Hilft Patienten, die Auswirkungen von Essen, Bewegung und Medikamenten auf den Blutzucker zu verstehen.



83% der Befragten bevorzugten das OneTouch Ultra Plus Reflect™ Messsystem und die OneTouch Reveal® Mobile App zu ihrem eigenständigen Messgerät**




* Therapieentscheidungen müssen sich nach dem absoluten gemessenen Wert und den ärztlichen Empfehlungen richten.

** Basierend auf einer in Großbritannien durchgeführten Studie (2018) mit einem simulierten Modells des OneTouch Ultra Plus Reflect™ Blutzuckermessgeräts und der OneTouch Reveal® Mobile App, stimmten 83% der 133 befragten Patienten zu.

Die dynamische ColourSure® Bereichsanzeige macht Patienten aufmerksam, wenn sie nahe an einer Über- oder Unterzuckerung sind

- Farbcodierte Tools können das eigenständige Management verbessern.
- Über- und Unterzuckerungen können vermieden werden.

Hilft Patienten zu verstehen, wie sie als nächstes reagieren sollten:

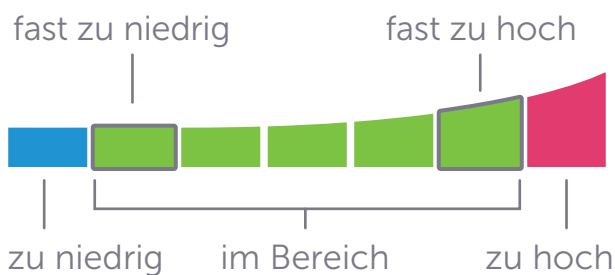

ColourSure®
PLUS

87% des medizinischen Fachpersonals stimmen zu, dass die dynamische ColourSure® Bereichsanzeige es ihnen erleichtern könnte, ihren Patienten die richtige Interpretation der Blutzuckerwerte zu erklären.*

* Basierend auf einer internationalen Studie (2018), durchgeführt mit einem simulierten OneTouch Ultra Plus Reflect™ Messgerät und der OneTouch Reveal® Mobile App, stimmten 87% der 355 Befragten des medizinischen Fachpersonals zu



Jetzt NEU: OneTouch Ultra Plus Reflect™

85% des medizinischen Fachpersonals sind der Meinung, dass das Messgerät Patienten zuversichtlich helfen könnte, Fortschritte im eigenen Diabetesmanagement zu machen.*



OneTouch Ultra Plus® Teststreifen†

Schnelle und genaue Ergebnisse

OneTouch® Delica® Stechhilfe

Nahezu schmerzarmes Testen**



Wir sind für Sie und Ihre Patienten da!

OneTouch® Auftragservice:

☎ 0800-75 03 000 gebührenfrei

☎ 0800-85 85 777 gebührenfrei

OneTouch® Kundenservice

in mehr als 20 Sprachen:

☎ 0800-70 77 007 gebührenfrei

www.onetouch.de

* Basierend auf einer internationalen Studie (2018), durchgeführt mit einem simulierten OneTouch Ultra Plus Reflect Messgerät und der OneTouch Reveal Mobile App, stimmten 85% der 355 Befragten des medizinischen Fachpersonals

** Von denen, die eine Präferenz geäußert haben und Erfahrungen mit dem Gebrauch der 30G OneTouch® Delica® Lanzette und mindestens einem anderen Lanzettengerät gemacht haben, haben 72% der 1.739 Teilnehmer zugestimmt. Basierend auf einer im Jahr 2016 in den USA durchgeführten Online-Umfrage.

† Entspricht den Kriterien der EN ISO 15197:2015. Testsysteme für die In-vitro-Diagnostik – Anforderungen an Blutzuckermesssysteme zur Eigenanwendung bei Diabetes mellitus (ISO 15197:2013); Deutsche Fassung EN ISO 15197:2015

‡ Dies gilt nicht für den Arzneiliefervertrag (ALV) der Primärkassen in Niedersachsen. Der Erstattungspreis im ALV der Primärkassen für die folgenden Regionen ergibt sich aus dem Apotheken-Einkaufspreis plus x%: Hessen (+5%), Brandenburg (+9,25%), Sachsen (+10%), Thüringen (+5%). Quelle: Lauer Taxe, Stand 01.11.2018

© LifeScan Deutschland GmbH, Düsseldorf, Deutschland